


# プラスオーソ リビジョンブレード

## 【禁忌・禁止】

1. 本品への二次加工禁止  
本品表面に衝撃や振動等を用いて印を刻み込む等の二次加工はしないこと。[折損の原因になります]
2. 粗雑な取扱いの禁止  
本品を変形あるいはキズをつける等、また、無理な力を加えたり、重いものを載せたりしないこと。[破損、欠損の原因となります。]

## 【形状・構造及び原理等】

材質：ステンレス鋼

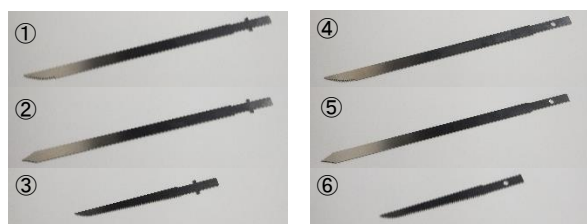

	製品番号	製品名
①	PO-008-01S	Esy-Revision Blade ロング片刃(遠位用) ストライカー用
②	PO-008-02S	Esy-Revision Blade ロング両刃(遠位用) ストライカー用
③	PO-008-03S	Esy-Revision Blade ショート(近位用) ストライカー用
④	PO-008-01P	Esy-Revision Blade ロング片刃(遠位用) パワープロ用
⑤	PO-008-02P	Esy-Revision Blade ロング両刃(遠位用) パワープロ用
⑥	PO-008-03P	Esy-Revision Blade ショート(近位用) パワープロ用

## 【使用目的又は効果】

本品は、人工股関節置換術の際に動力式の機械に取り付け使用する。

## 【使用方法等】

本品は未滅菌品です。使用に際しては必ず洗浄し、適切に機能することが確認された高圧蒸気滅菌法による標準的滅菌条件又は各医療機関で検証されバリデーションされた滅菌条件により滅菌を行うこと。

標準的滅菌条件の例：高圧蒸気滅菌（日本薬局方）

温度	時間
115-118℃	30分
121-124℃	15分
126-129℃	10分

## 【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
  - 1) 本品の使用前には必ず外観検査等の点検を行い、洗浄、滅菌を行うこと。
  - 2) 破損・変形・亀裂・傷・摩耗がないか、適切に機能するか点検すること。
  - 3) 使用前に本体の曲がりや刃の部分の欠損等の消耗がないか点検すること。
  - 4) ブレード装着後の操作時にスムーズに動作しない等作動不良の場合は、使用を中止し点検修理を依頼すること。
  - 5) 使用後は直ちに本品に折損・欠損等がないことを確認すること。折損、欠損等が見つかった場合は適切な処置を行うこと。

## 2. 不具合・有害事象

不具合

折損、破損、変形、分解、動作不良

有害事象

感染症、金属アレルギー、周囲等の神経障害、筋肉と軟部組織のゆるみ、血管・神経損傷、骨折、その他合併症等。

## 3. 高齢者への適用

骨密度が低下した高齢者は、術中に過度の力を加えることにより骨折等が起こる可能性が高いため、慎重に使用すること。

## 4. 過剰使用

- ・ 本品の使用に際し、意図しない使用方法の場合、応力による変形、折損の場合があり、正しく機能しなくなる。
- ・ 経年の度重なる使用による反復的な応力により、疲労を起こし破損に至ることがあるため、使用前に点検を行い、異常が見られたら使用しないこと。

## 【保管方法及び有効期間等】

保管方法

本品は高温・高湿・直射日光を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所に保管すること。

## 【保守・点検に係る事項】

1. 本品は日常点検及び使用前点検により正常に機能することを確認すること。汚れ、キズ、損傷等や異常が見られた場合には使用せず適切な処置を行うこと。
2. 洗浄
  - 1) 使用後は、早急に洗浄すること。
  - 2) 強アルカリ、強酸性洗剤・消毒剤は器具を腐食させる恐れがあるので、使用を避けること。
  - 3) 汚れの残存がある箇所には柔らかいブラシ、スポンジを使い、入念に洗浄すること。
  - 4) 洗浄に金属たわし、クレンザー（磨き粉）等の使用や過度の力による洗浄は器具の表面が損傷し、サビや腐食の原因となるので使用しないこと。
  - 5) 洗浄装置（超音波洗浄装置等）で洗浄するときには、金属物どうしが接触して先端部等損傷することがないように取扱うこと。
  - 6) 洗浄後はすぐに乾燥させること。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

トールーシード株式会社

京都府京都市中京区宗林町 98 英守ビル 207

TEL 075-708-5275